



# ภาคผนวก


ภาพกิจกรรมโครงการ “ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) โรงเรียนบ้านรัตน”  
กิจกรรม “สุขใจ ต้านภัย โควิด ๑๙”



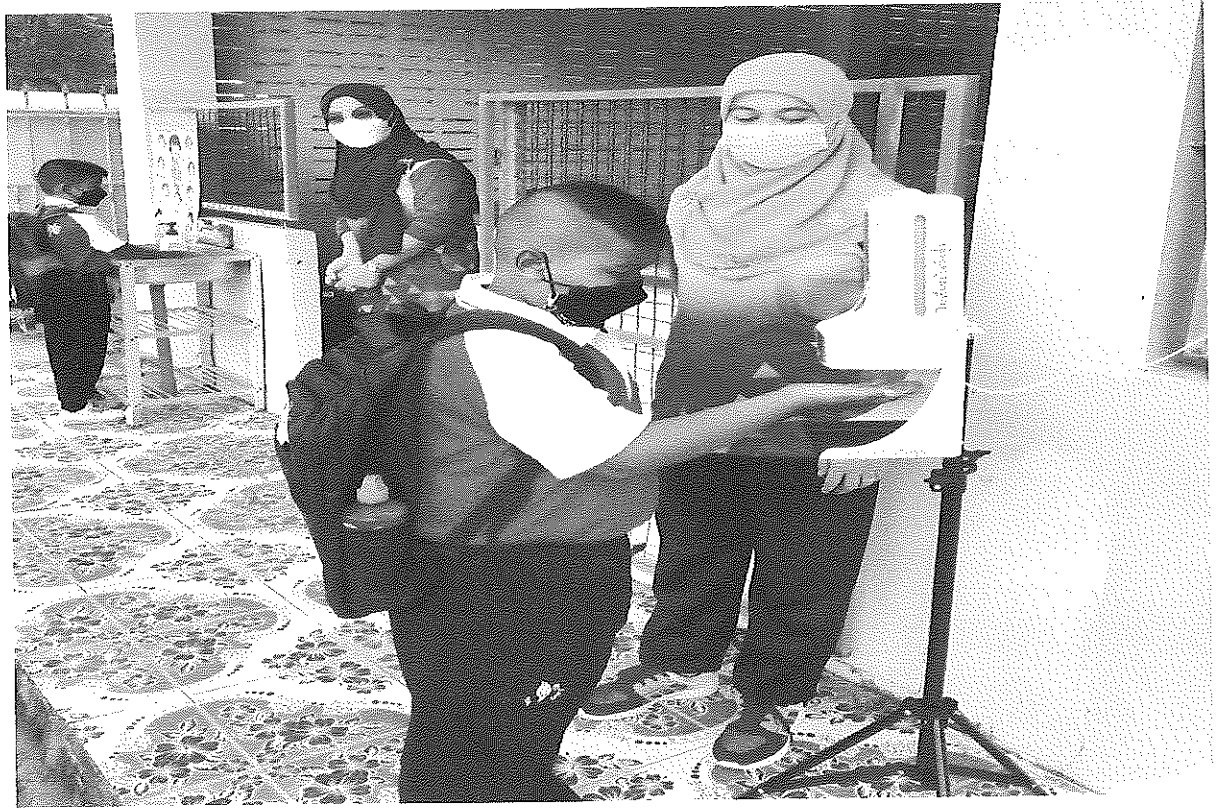

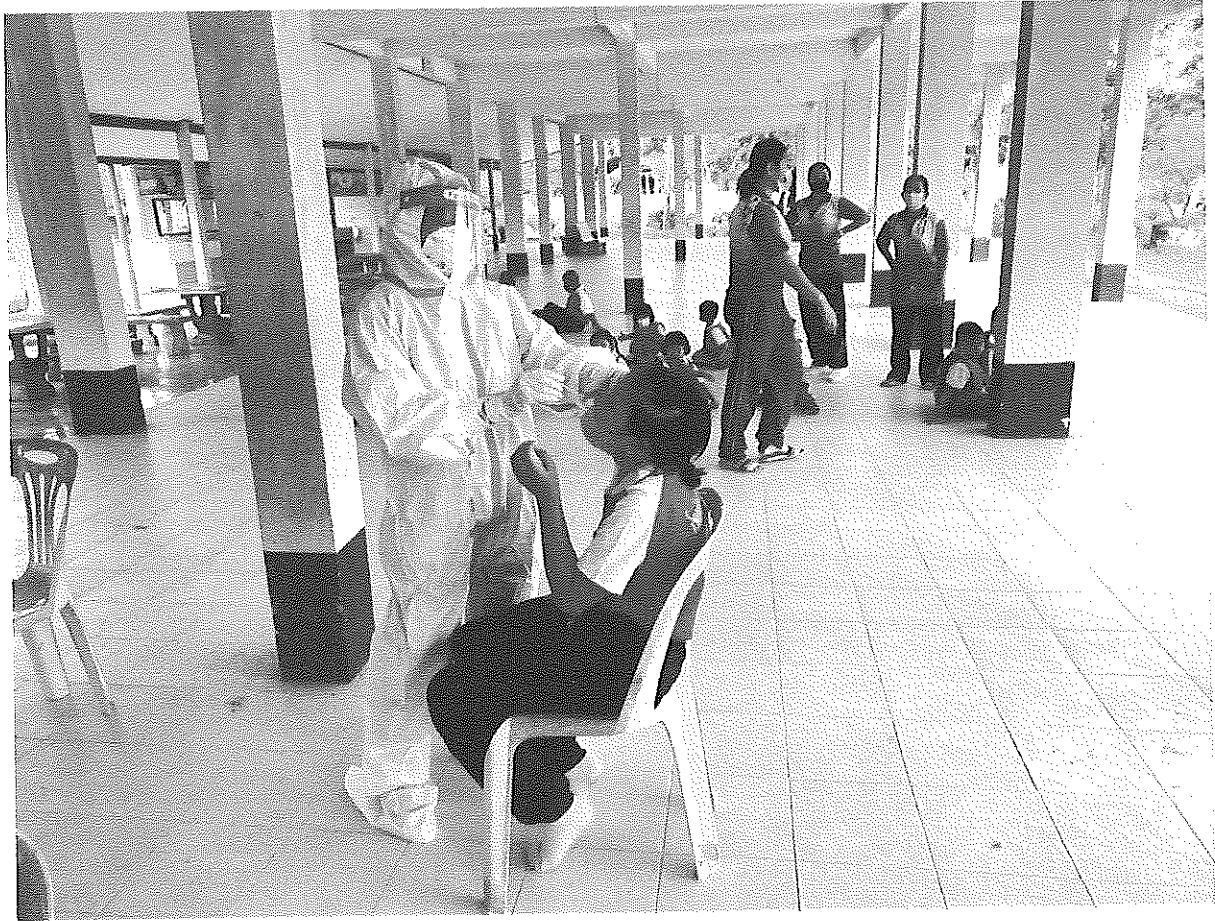



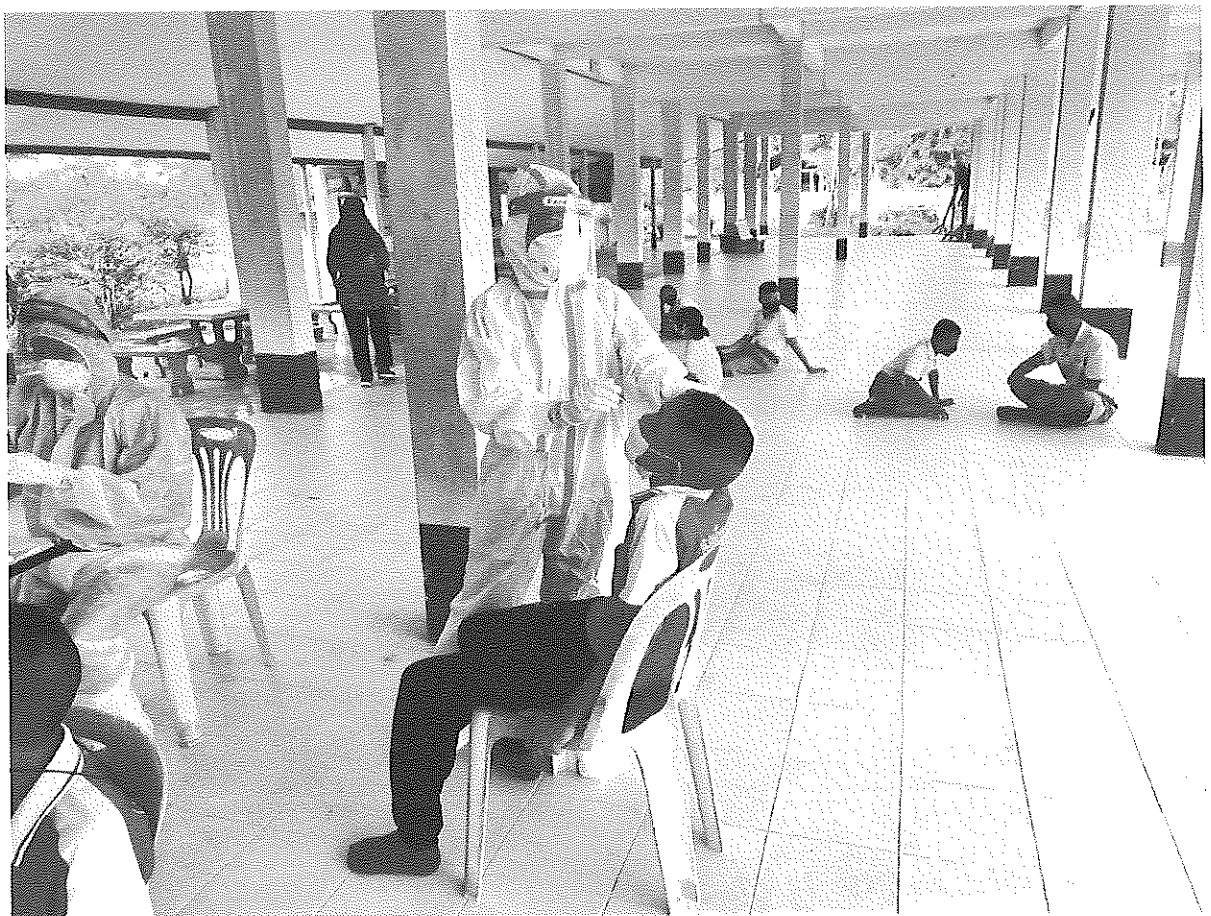





**GICA** สุขภาพ

**TESTSEALABS®**  
Rapid Test Kit

**COVID-19  
Antigen Test Cassette  
(Nasal&Saliva)**

ใช้เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาชนิดใหม่ (SARS-CoV-2) ที่ทำให้เกิด COVID-19  
 โดยวิธีตรวจหาแอนติเจนอย่างรวดเร็วในตัวอย่างน้ำมูกหรือน้ำลาย  
 ใช้สำหรับตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาชนิดใหม่ (SARS-CoV-2) ที่ทำให้เกิด COVID-19  
 (การตรวจหาแอนติเจนอย่างรวดเร็ว SARS-CoV-2 (เชื้อไวรัส COVID-19))  
 แบบพกพาและใช้คนเดียวได้ทันที

TESTSEALABS COVID-19 Antigen Test Cassette (Nasal&Saliva)

**ประเภท** เครื่องมือวินิจฉัยทางการแพทย์

**หมายเลข** TSC2101

**พหุคูณบรรจุ** 1 กระดาษทดสอบต่อกล่อง

**พหุคูณบรรจุพร้อมกล่องใส่** 10x5000x50

**ข้อบ่งใช้** ใช้เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาชนิดใหม่ (SARS-CoV-2) ที่ทำให้เกิด COVID-19  
 ใช้สำหรับตรวจหาแอนติเจนอย่างรวดเร็วในตัวอย่างน้ำมูกหรือน้ำลาย

**ปริมาณในการทดสอบ** ใช้สำหรับตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาชนิดใหม่ (SARS-CoV-2) ที่ทำให้เกิด COVID-19  
 จำนวนครั้ง 4 - 30 ครั้ง ต่อวัน

**อายุการใช้งาน** ภายใน 12 เดือน

**วันที่หมดอายุ** 15 วันก่อนวันหมดอายุในกล่องใส่ตัวอย่าง เมื่อหมดอายุ กรุณาทิ้ง  
 ให้ถูกวิธีตามคำแนะนำ

**ผู้ผลิต** บริษัท GICA จำกัด

**ผู้จำหน่าย** บริษัท GICA จำกัด โทร: 024-501-6777

**Chek**

CE





